



# Steritest™ Symbio泵启动快速指南


## 安装瓶架

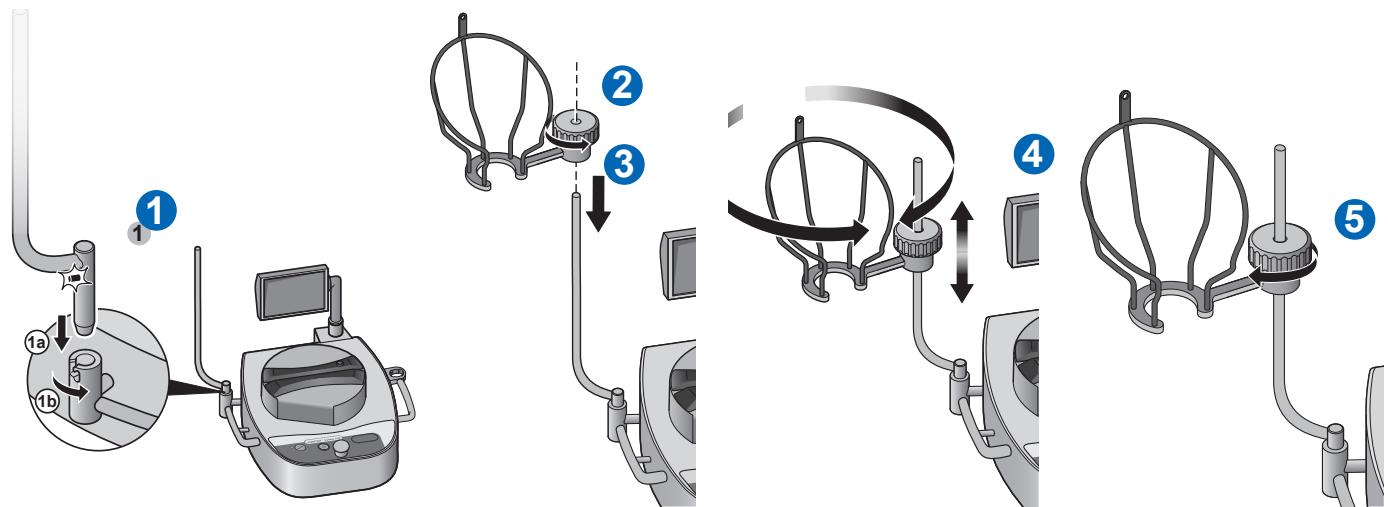


## 安装排水盘

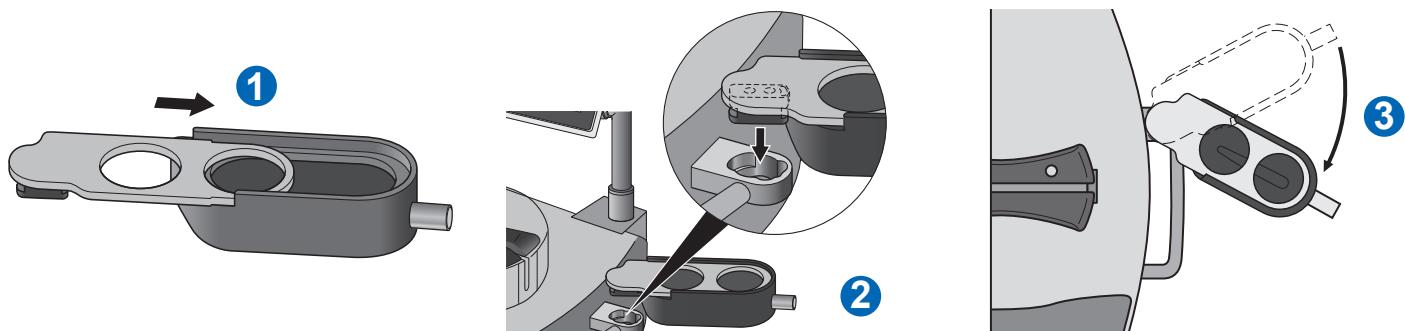

## 安装通信集线器

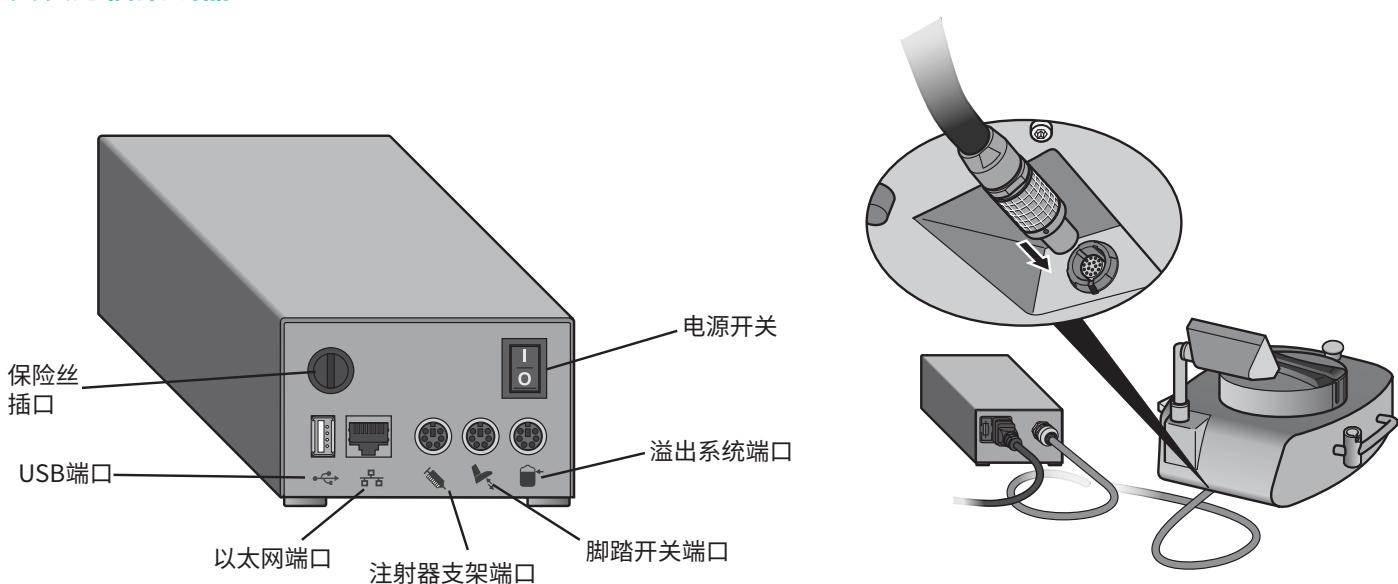

## 泵控制面板概览

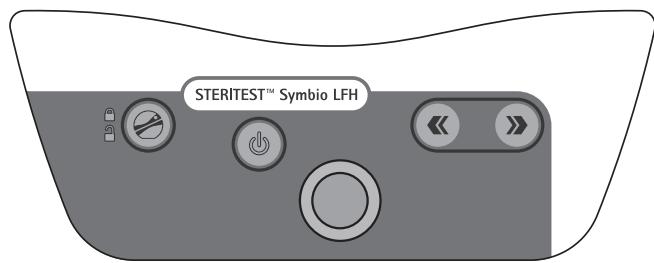

按电源开关开动或关停泵。

按打开/关闭按钮打开或关闭泵头。

按后退或下一步按钮执行各种操作。

旋转和按控制按钮执行各种操作。

## 开动泵

按电源开关(位置1)打开通讯集线器。

按住 按钮几秒钟开动泵。

这时画面上将显示Steritest™装置,然后显示欢迎画面。

第一次启动泵时,在泵证书激活前,即会接着显示泵证书画面。

**注:激活证书后,在欢迎画面之后将显示自动测试(Autotest)画面。**



如果泵已安装好且已准备好接受资格认证,则 和 以回答“是”。

根据指示激活泵证书。在此之后,时间开始倒计时,倒计时时间为12个月,倒计时结束时即是下一次校准的时间。

如果泵尚未准备好接受资格认证,则 和 以回答“否”。

这时将显示自动测试(Autotest)画面,并继续从工厂的校准日期开始倒计时至下一次校准时问。

当自动测试程序结束时,将显示辅件和数据来源画面。

复选框中的符号表示辅件或数据来源已连接到通讯集线器。



按动 。这时将显示主画面。

从主画面,您可以:

- 进入标准模式,可以手动模式使用泵。
- 进入测试方法模式,在该模式下,可以预定的程序使用泵。
- 进入配置菜单,以配置泵参数及其辅件,并将测试方法上传到泵。

