


# Kurzanleitung für die Benutzeroberfläche der Steritest™ Symbio-Pumpe

## Anwendung des Standardmodus

Drücken Sie um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

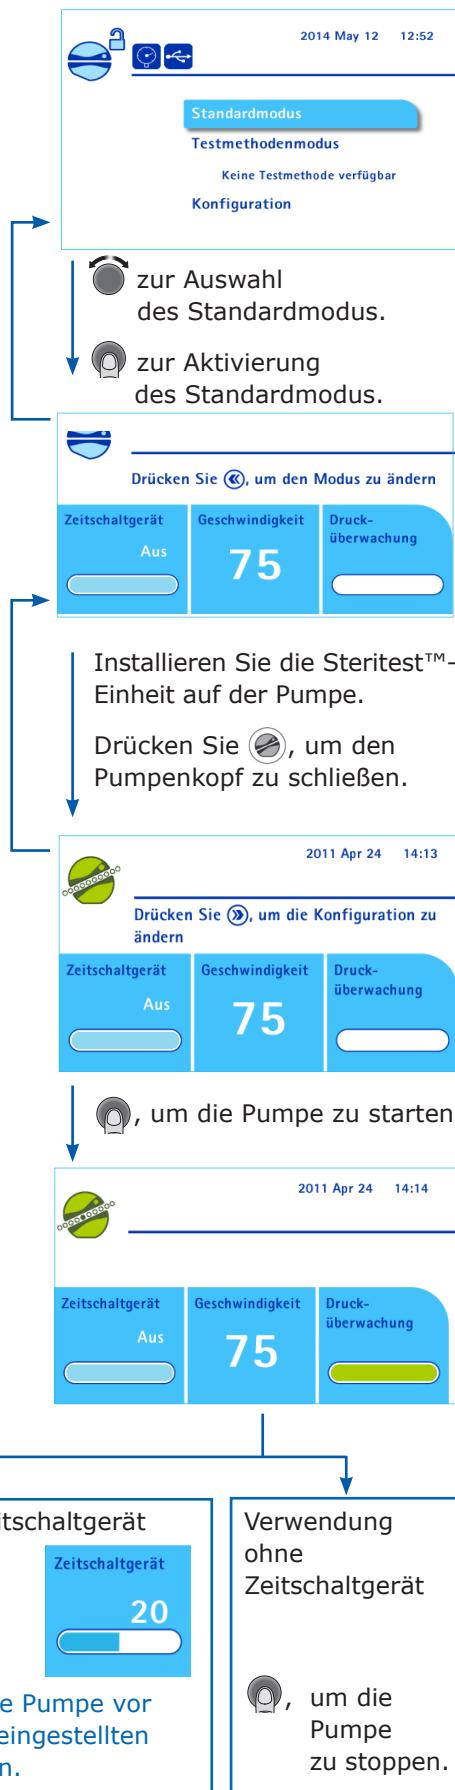

Drücken Sie , um den Pumpenkopf zu öffnen.

für 2 Sekunden, um das Zeitschaltgerät einzustellen.

Hinweis: Bei laufender Pumpe nicht verfügbar.

jederzeit, um die Pumpendrehzahl einzustellen.

Verwendung mit Zeitschaltgerät  
Die Pumpe stoppt automatisch, wenn der eingestellte Wert erreicht ist.

Hinweis: , um die Pumpe vor dem Erreichen des eingestellten Sollwerts zu stoppen.

## Konfiguration der Pumpe

### Konfiguration

Beenden



#### Druckmodus


- Fußschalter
- Spritzenhalter
- Datum und Uhrzeit
- Sprache
- Pumpeninformationen
- Alarmlautstärke
- Helligkeit
- Methodentransfer
- Netzwerkkonfiguration
- Drucksensortest

## Drucküberwachungsmodus


Der Druck in den Steritest™ Kanistern wird durch einen Farbbalken angezeigt.



**Grün:**  
Normaler Druck



**Orange:**  
Hoher Druck



**Rot:** Überdruck   
Die Pumpe sollte gestoppt werden.

## Druckregulierungsmodus



Hinweis: Nicht mit Zeitschaltgerät und Spritzenhalterung kompatibel.

Wie der Drucküberwachungsmodus, jedoch mit automatischer Drehzahlreduzierung, um den Druck im Kanister zu verringern.



## Anwendung des Testmethodenmodus

Hinweis: Dieser Modus ist nur verfügbar, wenn bereits Testmethoden mithilfe der Steritest™ Symbio-Software auf die Pumpe geladen wurden.

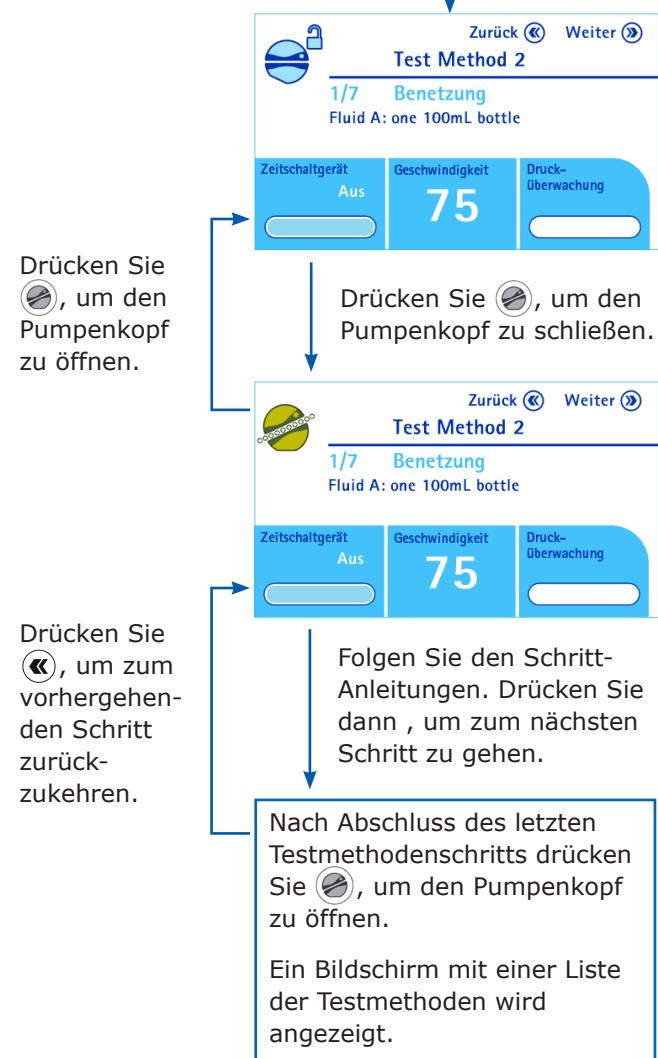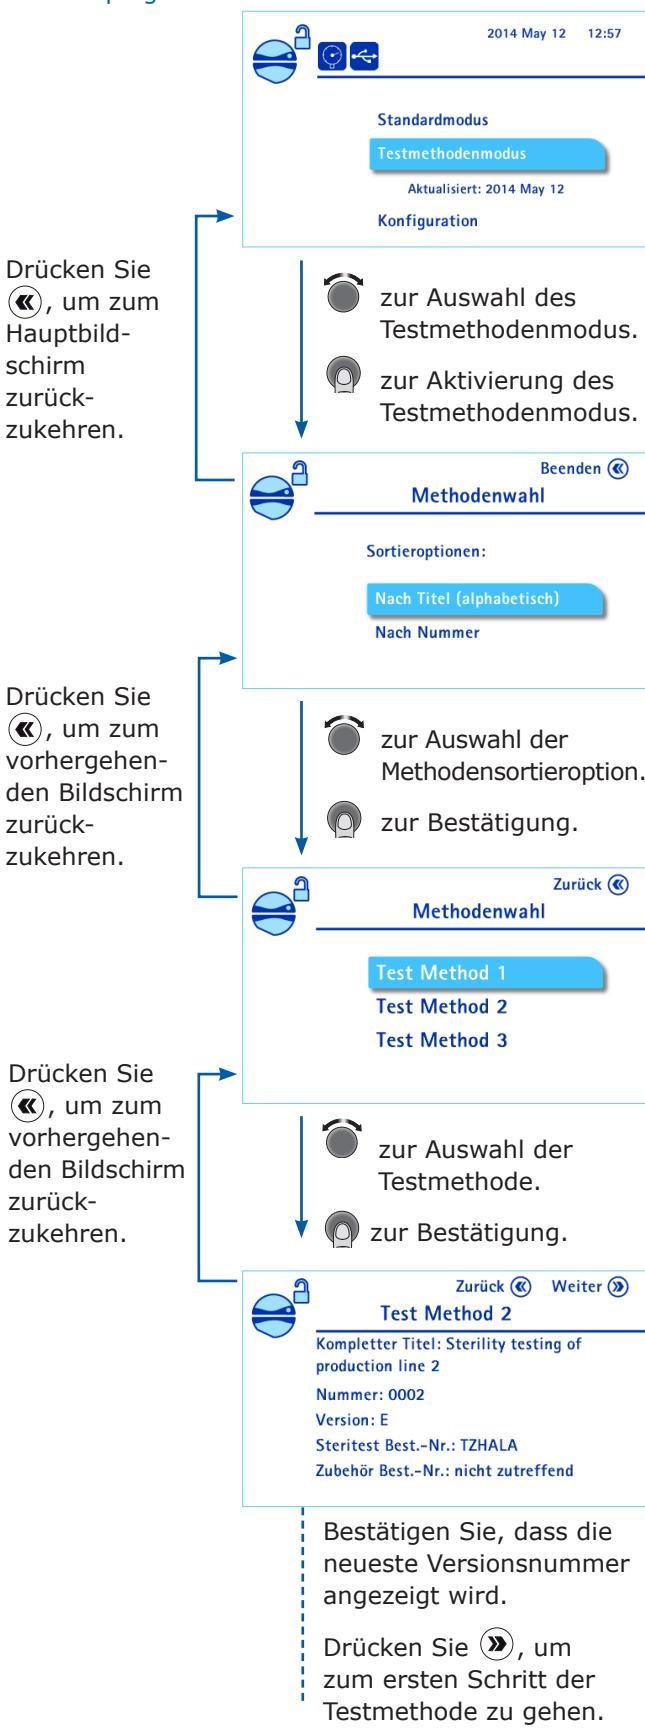

## Filtrationsparameter im Testmethodenmodus

Die Filtrationsparameter sind im Testmethodenmodus vordefiniert.

#### Regulierung der Pumpendrehzahl

 zur Regulierung der Pumpendrehzahl.

## Einstellung des Zeitschaltgeräts

Die Voreinstellung des Zeitschaltgeräts kann nicht geändert werden.

 , um die Pumpe vor dem Erreichen des Sollwerts zu stoppen.

## Druckmodus

Der vordefinierte Druckmodus kann nicht geändert werden. Siehe „Anwendung des Standardmodus“ auf der Rückseite dieser Kurzanleitung.

Hinweis: Sie können die komplette Gebrauchsanleitung für die Steritest™ Symbio-Pumpe auf folgender Webseite herunterladen: [www.millipore.com/steritest-symbio](http://www.millipore.com/steritest-symbio).

© 2019 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Merck, Steritest, Sigma-Aldrich und Millipore sind Marken der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland oder ihrer Tochterunternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Ausführliche Informationen zu Markennamen sind über öffentlich zugängliche Informationsquellen erhältlich. PE16602D Version 3.0 01/2019

Markennamen sind über öffentlich zugängliche Informationsquellen erreichbar. PF16602DE Version 3.0 01/2019  
**Der Unternehmensbereich Life Science der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland tritt in den USA und in Kanada als MilliporeSigma auf.**

MERCK